

Mode d'emploi

Ceinture de fréquence cardiaque






N° de modèle : AF5-CDBT-5

Edition de : S. 19/15 A




Répertoire

1.	Vue d'ensemble	3
2.	Utilisation	4
3.	Contenu de livraison/pièces de l'appareil	4
4.	Codes QR.....	5
5.	Généralités.....	6
5.1.	Lire le mode d'emploi et le conserver	6
5.2.	Légende des symboles.....	6
6.	Sécurité	7
6.1.	Utilisation conforme à l'usage prévu	7
6.2.	Consignes de sécurité.....	8
6.3.	Vérifier la ceinture de fréquence cardiaque et le contenu de la livraison.....	12
7.	Ceinture de fréquence cardiaque.....	13
7.1.	Fonctions.....	13
7.2.	Modes de transmission.....	13
7.3.	Appareils Bluetooth® compatibles	14
7.4.	Étanchéité.....	14
8.	Utilisation	15
8.1.	Monter la ceinture de fréquence cardiaque.....	15
8.2.	Télécharger et installer l'application Crane Connect.....	15
8.3.	Créer utilisateur.....	16
8.4.	Mettre la ceinture de fréquence cardiaque.....	17
8.5.	Connecter la ceinture de fréquence cardiaque par Bluetooth®	18
9.	Nettoyage et entretien	19
9.1.	Remplacement de la pile	19
9.2.	Nettoyer la ceinture de fréquence cardiaque	20
9.3.	Conserver la ceinture de fréquence cardiaque.....	21
10.	Recherche d'erreurs	21
11.	Déclaration de conformité.....	23
12.	Données techniques.....	23
13.	Élimination.....	23
13.1.	Élimination de l'emballage.....	23
13.2.	Éliminer la ceinture de fréquence cardiaque.....	23

1. Vue d'ensemble

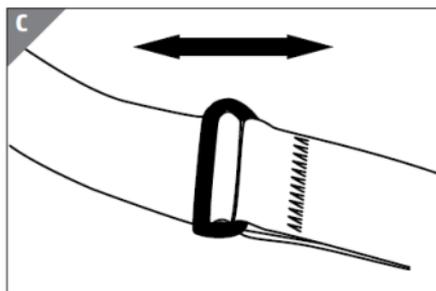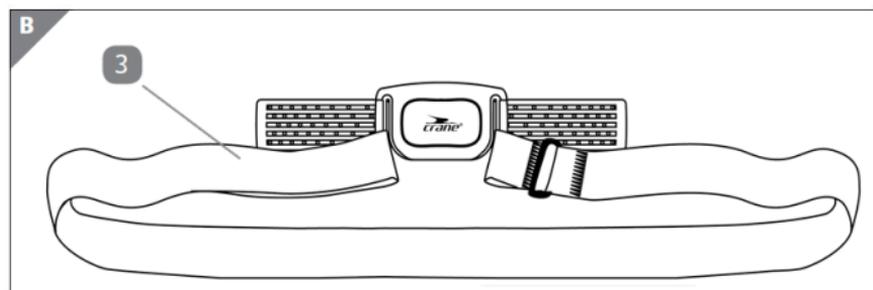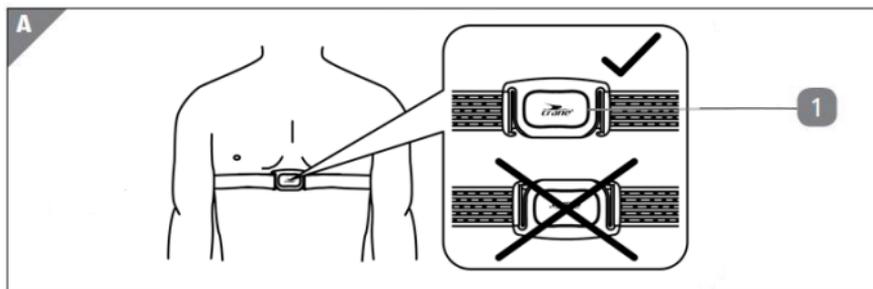

2. Utilisation

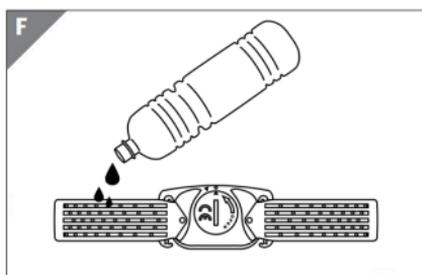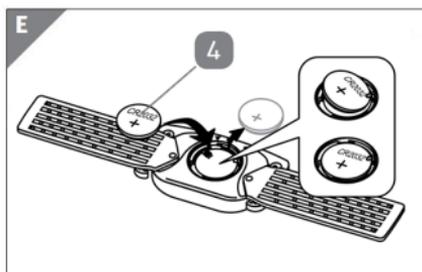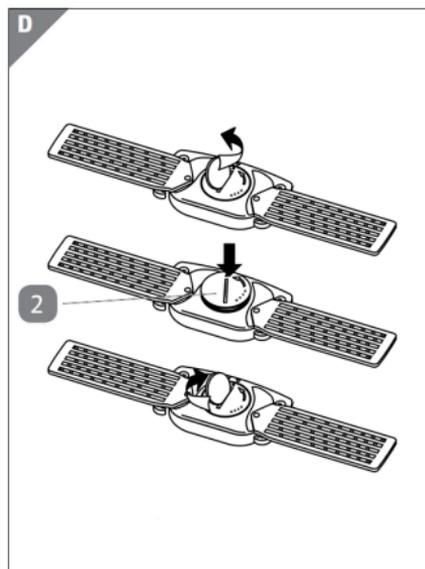

3. Contenu de livraison/pièces de l'appareil

- 1 Unité émettrice
- 2 Couvercle du compartiment à piles
- 3 Ceinture
- 4 Pile

4. Codes QR

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin d'informations sur les produits, de pièces de rechange ou d'accessoires, de données sur les garanties fabricant ou sur les unités de service ou si vous souhaitez regarder confortablement des instructions en vidéo – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet*. Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Aldi.*



* L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

5. Généralités

5.1. Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi fait partie de cette ceinture de fréquence cardiaque Bluetooth®. Il contient des informations importantes pour l'utilisation et la manipulation. Pour garantir une compréhension facile, la ceinture de fréquence cardiaque Bluetooth® est appelé par la suite seulement ceinture de fréquence cardiaque.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la ceinture de fréquence cardiaque. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des dommages sur la ceinture de fréquence cardiaque.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures.

Si vous transmettez la ceinture de fréquence cardiaque à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

5.2. Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la ceinture de fréquence cardiaque ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir de grave conséquence et entraîner des blessures.



PRÉCAUTION! Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.



SIGNALISATION! Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'exploitation.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués de ce symbole satisfont les exigences des directives R&TTE 1999/5/CE et RoHS 2011/65/UE.

6. Sécurité

6.1. Utilisation conforme à l'usage prévu

« La ceinture de fréquence cardiaque est conçue exclusivement pour la mesure de votre fréquence cardiaque lors du sport. La ceinture de fréquence cardiaque est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est

pas adapté à une utilisation commerciale, thérapeutique ou médicale. Ce n'est pas un jouet et ce n'est pas un appareil médical il est donc sensible aux interférences de sources électriques externes. Les relevés de fréquence cardiaque sont uniquement fournis à titre indicatif et nul ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'un relevé

erroné. Utilisez la ceinture de fréquence cardiaque uniquement comme c'est décrit dans ce mode d'emploi.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et même personnels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

6.2. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT!

Risque d'ingestion et d'étouffement!

Risque d'ingestion et d'étouffement!
Si des enfants ou animaux avalent l'unité émettrice, la pile, ou autre partie de l'appareil ils peuvent s'étouffer.

- Éloignez l'unité émettrice des enfants et d'animaux.
- Consultez immédiatement un médecin lorsque des enfants ou animaux ont avalé l'unité émettrice ou une pile.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Un maniement inapproprié peut provoquer des blessures graves.

- Si vous portez un pacemaker, parlez obligatoirement à votre médecin avant de porter pour la première fois la ceinture de fréquence cardiaque à l'entraînement.
- Parlez à votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'entraînement avec la ceinture de fréquence cardiaque.



AVERTISSEMENT!

Risque d'explosion!

Les piles peuvent exploser si elles sont fortement chauffées.

- Ne chauffez pas la pile, éloignez-la de surfaces chaudes et ne la jetez pas dans un feu ouvert.
- Protégez l'unité émettrice et la pile des rayons directs du soleil.



AVERTISSEMENT!

Risque de brûlures chimiques par l'acide de batterie.

Une fuite d'acide de batterie peut provoquer des brûlures.

- Évitez le contact d'acide de batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.

- En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement les endroits concernés avec beaucoup d'eau claire et consultez éventuellement un médecin.



PRÉCAUTION!

Risque de blessure!

Une utilisation incorrecte peut provoquer des blessures.

- N'utilisez pas la ceinture de fréquence cardiaque si elle présente des dommages visibles.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations.
- Ouvrez le boîtier de l'unité émettrice seulement pour remplacer la pile, et laissez la réparation aux professionnels. Adressez-vous pour ceci à notre service. En cas de réparations à sa propre initiative ou d'utilisation incorrecte, tout droit de responsabilité et de garantie est exclu.
- N'utilisez pas la ceinture de fréquence cardiaque en cas d'allergie au latex. La ceinture de fréquence cardiaque peut contenir des éléments de latex et provoquer chez vous éventuellement des irritations de la peau et des rougissements.

- N'utilisez plus la ceinture de fréquence cardiaque si vous constatez pendant l'entraînement de légers rougissements sur la peau. Consultez immédiatement un médecin.



SIGNALISATION!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de la ceinture de fréquence cardiaque peut provoquer des dommages.

- Ne rangez pas l'unité émettrice de manière à ce qu'elle puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne rechargez plus la pile.
- Enlevez la pile de l'unité émettrice dès qu'elle est déchargée. Les piles usées ont plus tôt des fuites.
- Enlevez la pile de l'unité émettrice si vous n'utilisez plus la ceinture de fréquence cardiaque pendant une période prolongée.
- Utilisez la ceinture de fréquence cardiaque à une température ambiante entre -10°C et $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ne plongez pas l'unité émettrice dans l'eau ou autres liquides.
- Éloignez la ceinture de fréquence cardiaque d'un

feu ouvert et de surfaces brûlantes.

- Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement.
- Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile.

6.3. Vérifier la ceinture de fréquence cardiaque et le contenu de la livraison



SIGNALISATION!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la ceinture de fréquence cardiaque.

- Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez la ceinture de fréquence cardiaque de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).
3. Vérifiez si l'unité émettrice **1** ou la ceinture **3** présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la ceinture de fréquence cardiaque. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

7. Ceinture de fréquence cardiaque

7.1. Fonctions

Avec la ceinture de fréquence cardiaque, vous pouvez mesurer pendant l'entraînement votre fréquence cardiaque.

Les données mesurées seront transmises à un appareil, par ex. votre smartphone. Avec l'application gratuite Crane Connect, vous avez ensuite la possibilité d'analyser amplement ces données. Vous pouvez trouver les informations suivantes pour votre entraînement de l'application Crane Connect après l'avoir installé:

- Mesure de fréquence cardiaque
- Zones d'entraînement
- Consommation de calories
- Tracking GPS
- Durée de l'activité
- Distance parcourue
- Vitesse (actuelle et moyenne)
- Pace (actuelle et moyenne)
- Sélection personnelle de musique
- Journal d'entraînement
- Mode km ou miles

7.2. Modes de transmission

La fréquence cardiaque est transmise par la technologie Bluetooth® 4.0 à votre smartphone.

A l'aide de la technologie Bluetooth® 4.0, il est possible de s'entraîner en groupe sans interférence.

7.3. Appareils Bluetooth® compatibles

Les appareils suivants, équipés de Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0), sont compatibles avec la ceinture de fréquence cardiaque et l'application:

- Apple® iPhone® 4s et versions ultérieures
- Apple® iPad® de la 3e génération et versions ultérieures
- Apple® iPad mini™ de la 1ère génération et versions ultérieures
- Apple® iPad Air™ et versions ultérieures
- Smartphones et tablettes avec Android™ 4.3 et versions ultérieures



SIGNALISATION!

Vous pouvez trouver une liste de tous les appareils supportés sur Internet à www.cranesportsconnect.com/compatibilite.

7.4. Étanchéité

Vous pouvez vérifier dans le tableau suivant dans quelle situation la ceinture de fréquence cardiaque est étanche jusqu'à 3 bar.

	Situation	Étanchéité jusqu'à 3 bar
	Éclaboussure de pluie	Oui
	Lavage de main (éclaboussure d'eau)	Oui, mais ne pas plonger la ceinture de fréquence cardiaque dans l'eau

	Situation	Étanchéité jusqu'à 3 bar
	Douche	Non
	Baignade/natation	Non
	Sport aquatique (par ex. plongée)	Non

L'indication bar se réfère à la surpression d'air appliquée dans le cadre de contrôle d'étanchéité selon DIN 8310 sur l'unité émettrice.

8. Utilisation

8.1. Monter la ceinture de fréquence cardiaque

- Connectez l'unité émettrice **1** avec la ceinture élastique **3**.
(voir **figure B + C**)

Vous avez monté avec succès la ceinture de fréquence cardiaque et vous pouvez l'utiliser maintenant.

8.2. Télécharger et installer l'application Crane Connect

Si vous voulez utiliser la ceinture de fréquence cardiaque ensemble avec l'application Crane Connect, vous devez d'abord télécharger l'application Crane Connect et l'installer sur votre smartphone.

- Téléchargez l'application Crane Connect gratuite de l'App Store, de Google Play Store ou par le code QR suivant.

Code QR pour Android:



Code QR pour iOS:



- Installez l'application Crane Connect sur votre smartphone.



SIGNALISATION!

- Suivez les instructions sur votre smartphone.

8.3. Créer utilisateur

Pour créer un utilisateur sur l'application Crane Connect, procédez comme suit:

1. Ouvrez l'application Crane Connect sur votre smartphone.
Dans le menu d'accueil, vous avez le choix des points suivants:
 - Ceinture de fréquence cardiaque
 - Vidéos d'apprentissage
 - Tous les réglages
 - FAQ: Dépannage
2. Pour effectuer les réglages spécifiques à l'utilisateur et au produit, sélectionnez le symbole «Tous les réglages». Différents symboles apparaissent à l'écran.
3. Pour créer un nouvel utilisateur ou pour se connecter avec un utilisateur déjà existant, sélectionnez le symbole «Paramètres utilisateurs». Suivez les instructions suivantes de l'application Crane Connect étape par étape.



SIGNALISATION!

Vous pouvez créer aussi de nouveaux utilisateurs sur la page d'Internet www.cranesportsconnect.com.

8.4. Mettre la ceinture de fréquence cardiaque

1. Humidifiez les contacts du capteur du côté intérieur lisse de l'unité émettrice **3** avec par ex. un peu d'eau (voir **figure F**).
Vous assurez ainsi un bon contact à la peau.
2. Assemblez la ceinture et l'unité émettrice **1** (voir chapitre «Monter la ceinture de fréquence cardiaque»).
3. Mettez-vous la ceinture de fréquence cardiaque élastique de manière à ce que les capteurs se trouvent sur la poitrine en-dessous des muscles pectoraux ou en-dessous de la poitrine, et que l'unité émettrice n'est pas à l'envers (voir **figure A**).
4. Corrigez éventuellement l'assise de la ceinture pour qu'elle soit tendue mais encore confortable (voir **figure C**).
La ceinture ne doit ni glisser par le bas ni provoquer des douleurs pour vous.



SIGNALISATION!

Évitez pendant l'entraînement des champs magnétiques forts (par ex. des transformateurs) puisque des écarts peuvent survenir lors de la transmission des fréquences cardiaques mesurées.

8.5. Connecter la ceinture de fréquence cardiaque par Bluetooth®



SIGNALISATION!

Veillez à ce que la fonction Bluetooth® est activée sur votre smartphone.

Si vous avez créé un utilisateur et effectué les réglages produit, vous pouvez connecter la ceinture de fréquence cardiaque à votre smartphone par Bluetooth®.

1. Pour connecter votre ceinture de fréquence cardiaque à votre smartphone via Bluetooth®, sélectionnez dans le menu «Tous les réglages» le symbole App „Ceinture de fréquence cardiaque“.

Le menu «Réglages» apparaît à l'écran. Vous trouvez ici d'autres possibilités de réglage pour la ceinture de fréquence cardiaque.

2. Mettez la ceinture de fréquence cardiaque avant de la connecter à votre smartphone (voir chapitre «Mettre la ceinture de fréquence cardiaque»).
3. Connectez la ceinture de fréquence cardiaque à votre smartphone en sélectionnant dans le champs «Pairs» l'option «Connecter».

Votre smartphone se connecte maintenant à la ceinture de fréquence cardiaque.

4. Retournez au menu d'accueil.
5. Pour arriver directement à la mesure de fréquence cardiaque et à toutes les analyses, sélectionnez le symbole «Ceinture de fréquence cardiaque».
6. Feuilletez les différentes surfaces en déroulant avec le doigt vers la droite.



SIGNALISATION!

Si la connexion Internet est activée sur votre smartphone, toutes les données d'entraînement sont téléchargées automatiquement après l'entraînement par l'application Crane Connect sur le site Internet www.cranesportsconnect.com et enregistrées là-bas durablement.

9. Nettoyage et entretien

9.1. Remplacement de la pile



SIGNALISATION!

Risque d'endommagement!

Si vous ne fermez pas correctement le couvercle du compartiment à piles, de l'humidité peut s'infiltrer dans l'unité émettrice. L'unité émettrice peut être cassée ainsi.

Fermez soigneusement le couvercle du compartiment à piles pour que l'humidité ne puisse pas s'infiltrer dans l'unité émettrice.

1. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles **2**, tournez une pièce de monnaie dans le sens contraire de la montre (voir étape 1 dans **figure D**).
2. Enlevez l'ancienne pile et insérez une nouvelle du même type à la même position (voir **figure E**).
N'enlevez pas l'étiquette blanche dans le compartiment à piles. La pile doit être placée en-dessous d'un petit crochet métallique dorée, et le pôle positif doit être orienté vers le haut.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles (voir étape 2 dans **figure D**).
4. Pour fermer le couvercle du compartiment à piles, tournez

une pièce de monnaie dans le sens de la montre (voir étape 3 dans **figure D**).

9.2. Nettoyer la ceinture de fréquence cardiaque



SIGNALISATION!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de la ceinture de fréquence cardiaque peut provoquer des dommages.

- Ne plongez pas l'unité émettrice dans l'eau ou autres liquides.
- Ne séchez pas la ceinture de fréquence cardiaque dans le sèche-linge.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

Vous pouvez laver la ceinture à la main ou dans la machine à laver.

- Lavez la ceinture **3** en-dessous de l'eau courante et éventuellement avec un peu de savon doux.
- Ou lavez la ceinture dans la machine à laver à 40 °C et sans assouplissant.
- Essuyez l'unité émettrice **1** avec un chiffon doux non pelucheux.
- Laissez sécher complètement à l'air l'unité émettrice et la ceinture avant de les ranger.

9.3. Conserver la ceinture de fréquence cardiaque

Lorsque vous avez enlevé la pile, vous pouvez entreposer la ceinture de fréquence cardiaque entre -20 °C et +70 °C.

10. Recherche d'erreurs

Utilisez les informations suivantes et nos FAQ (questions fréquemment posées) sur notre site Internet pour corriger vous-même des erreurs: www.cranesportsconnect.com/faq

Défaillance	Solution
La ceinture de fréquence cardiaque ne se connecte pas à l'application Crane Connect.	• Vérifiez si votre smartphone est compatible.
	• Vérifiez si la pile est insérée correctement.
La ceinture de fréquence cardiaque ne se connecte pas à l'application Crane Connect.	• Vérifiez si la ceinture est correctement serrée et bien humidifiée.

Défaillance	Solution
La ceinture de fréquence cardiaque perd la connexion à l'application Crane Connect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la ceinture est correctement serrée et bien humidifiée.
La ceinture de fréquence cardiaque perd la connexion à l'application Crane Connect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion est interrompue par des champs magnétiques à proximité.
La ceinture de fréquence cardiaque transmet une fausse fréquence cardiaque à l'application Crane Connect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion est interrompue par des champs magnétiques fortes à proximité (par ex. des postes à souder électriques, transformateurs, robots tondeuse à gazon).
La ceinture de fréquence cardiaque transmet une fausse fréquence cardiaque à l'application Crane Connect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la pile est faible ou déchargée.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la ceinture est correctement serrée et bien humidifiée.



SIGNALISATION!

- Avant de réclamer la ceinture de fréquence cardiaque, veuillez vérifier si la pile est déchargée et remplacez-la éventuellement.

11. Déclaration de conformité

Krippel-Watches déclare par la présente que la ceinture de fréquence cardiaque Bluetooth® (No modèle AF5-CDBT-5) est conforme aux exigences de base et des autres dispositions pertinentes des directives R&TTE 1999/5/CE et RoHS 2011/65/UE.

Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de conformité sur notre page d'accueil Internet:

www.produktservice.info (code EAN: 26015118).

12. Données techniques

No modèle:	AF5-CDBT-5
No d'article:	1511
Température de fonctionnement:	-10 °C à +60 °C
Pile:	3 V DC, 0,5 mA, CR2032
Fréquence de transmission:	Bluetooth® 4.0 (~2,4 GHz)

13. Élimination

13.1. Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

13.2. Éliminer la ceinture de fréquence cardiaque



Éliminez la ceinture de fréquence cardiaque selon les dispositions et lois en vigueur dans votre pays.



Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!



En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Veuillez déposer la pile uniquement dans un état de déchargement complet, à votre point de collecte.

* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Importateur:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels, AUSTRIA

CARTE DE GARANTIE

Ceinture de fréquence cardiaque S. 19/15 A

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le SAV indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte. Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux): 1.

La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Service CLIENTÈLE

Nous vous rappelons que pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons accepter **aucun paquet** envoyé en port **du et sans notification préalable.** Vous devez **d'abord** consulter **notre page d'accueil SAV** ou nous contacter à l'**adresse e-mail** indiquée ou sur notre **hotline SAV.**

Veuillez vous munir du **numéro de modèle** du produit, indiqué **au dos** ou **sous** le produit.

 www.produktservice.info
 service@produktservice.info
 01.49.19.49.35

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparation seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

Veillez envoyer votre appareil soigneusement emballé (sans la boîte) à l'adresse suivante :

Krippel-Watches
Le Dôme - 1, rue de La Haye – BP12910
F-95731 Roissy CDG Cedex
Tel : ++33/1-49194935

et y joindre ce bon de garantie. Veuillez remplir en MAJUSCULES la demande d'adresse ci-après, pour nous faciliter la réexpédition :

Nom _____

Rue _____

Code postal, ville _____

Numéro de téléphone _____

E-mail _____